



SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO
FALLO Y RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLCC28/2022
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS”
(Sistema de Evaluación Binario)

En la ciudad de Guadalajara, Jal., al 16 día del mes de diciembre del año 2022, siendo las 10:15 horas, en la Sala de Juntas de Subdirección General Administrativa, ubicada Av. Alcalde No. 1220, en la colonia Miraflores, se reunieron en la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria los miembros del Comité de Adquisiciones mismos que firman al calce, a efecto de emitir el fallo de la **Licitación Pública Local con Concurrencia de Comité LPLCC-28/2022 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS”** de conformidad con los artículos 66 y 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante, La Ley), artículo 69 del Reglamento de la citada Ley, se hace la siguiente relación de:

RESULTANDO Y CONSIDERANDO:

1.- Con fecha 25 días del mes de noviembre del año 2022, en cumplimiento al artículo 60 de La Ley, fue publicada la convocatoria, correspondiente a la Licitación LPLCC-28/2022 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS”.

2.- El día 02 del mes de diciembre del año 2022, se fijó como fecha para desahogo de la Junta Aclaratoria correspondiente al presente proceso de adquisición, conforme al punto 3 de las bases y el artículo 63 de La Ley, dirigiendo y desahogando la misma el Lic. Roberto Alejandro Valladares Zamudio, Director de Recursos Materiales, representante de la Unidad Centralizada de Compras, C. Elizabeth Vázquez Barajas, Apoyo Administrativo CAHPSIC y representante del área requirente.

3.- Con fecha 06 del mes de diciembre del año 2022 y como parte del proceso de adquisición, fueron presentadas y aperturadas las propuestas de los licitantes interesados, evento que se desarrolló de acuerdo a los hechos plasmados en el acta correspondiente, presentando propuestas los siguientes licitantes:

1. JOSE MARIA DE ALBA CERNA.
2. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV
3. INFARID SA DE CV
4. SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, S.A. DE C.V.
5. MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES SA DE CV

Vistos los antecedentes dentro del proceso de licitación que nos ocupa, se exponen los siguientes:

CONSIDERANDOS

Una vez analizadas y revisadas las propuestas técnicas y económicas, y conforme al dictamen realizado por el C. Elizabeth Vázquez Barajas, Apoyo Administrativo CAHPSIC y representante del área requirente, se exponen las mismas para un mejor proveer, identificando los aspectos técnicos y económicos requeridos por la convocante en las bases del proceso LPLCC-28/2022 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS”.

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO
FALLO Y RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLCC28/2022
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS"
(Sistema de Evaluación Binario)

ESPECIFICACIÓN			PROPUESTAS TÉCNICAS									
PASTRA	L. MEDIDA	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	JOSE MARIA DE ALBA CERNA		IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTAL SA DE CV		INTARIND SA DE CV		MEDIC MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES SA DE CV		SERCO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	
			CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Pieza	Autoclave, Equipo de esterilización a vapor con control de ciclos de esterilización por microcontrolador. Cámara y charcos en acero inoxidable. Capacidad 12 LTS con tres programas de esterilización y programa de secado. Con medidas de 33 CM de ancho, 35.5 CM de alto y 63 CM de largo mas menos	X		X		X		X		X	
2	Pieza	Báscula con estadiómetro, para medir estatura y peso, de gran exactitud, lectura directa en dos veras una de 220 kg y otra de 20 kg, Escala legible en ambas barras, la principal de 20 en 20 kg, División mínima de 100 gr. Barra de Zamac con cromado mate, Placas curvadas de Zamac esmaltadas colores beige o blanco, latido lineal. (Opción), telescópica, 2 puntos de fijación a la báscula para mejor ensamblaje, Escala para medir estatura hasta de 1.95mts, Mide altura desde 75cm a 183 cm, Fabricado en lámina de acero, Pintura epóxica horneada de alta resistencia, Tapete antiderripena.	X		X			No especifica características en su propuesta			X	
3	Pieza	Camita hidráulica para fisioterapia, 4 secciones, Dimensiones 70 x 190 cm mas menos. La estructura está fabricada en tubo de acero y recubierta de pintura epóxica en horno. Sistema de ruedas suaves, montado pedal único. Regulación de altura mediante mando de pie. Pata redondeada de alta resistencia. Relleno de espuma de 4 cm de grosor mas menos y cubierta en tela tipo vinil que no absorbe líquidos y es fácil de limpiar. Con soporte de hasta 150 kg aproximadamente.	X		NO PROPONE			No especifica características en su propuesta			NO PROPONE	
4	Pieza	Electrocardiograma portátil con 3 canales, pantalla LCD de 2.83" con batería recargable.	X		X		X		X		X	
5	Pieza	Estimulador muscular y de sistema nervioso ultra TENS Digital Recargable con cargador incluido.		Se solicita estimulador recargable con cargador incluido y el proveedor no especifica si lo incluye.	NO PROPONE		X				NO PROPONE	
6	Pieza	Estimulador muscular y de sistema nervioso ultra EMS Digital Recargable con cargador incluido.		Se solicita estimulador recargable con cargador incluido y el proveedor no especifica si lo incluye.	NO PROPONE			NO PROPONE			NO PROPONE	
7	Pieza	Lámpara con haz direccionable, infrarroja para terapia física con interruptor de encendido y apagado. Altura ajustable.		Se solicita con altura ajustable y el proveedor no especifica altura.	NO PROPONE		X				NO PROPONE	X
8	Pieza	Compresora de termoterapia de acero inoxidable, grado medico. Capacidad para 4 compresas de termoterapia estándar incluidas con la compresora de aproximadamente 34 cm largo x 25 cm ancho x 41 cm alto. Con regulador termostático de temperatura.	X		NO PROPONE			NO PROPONE			NO PROPONE	X
9	Pieza	Mesa pueril con bandeja inclinable, altura ajustable. Base en forma de H de acero con terminado esmaltado con cuatro ruedas giratorias. Con altura de entre 75 cm y 108 cm mas menos, con bandeja 60x35 x 78.5 CM mas menos.	X		NO PROPONE		X				NO PROPONE	X
10	Pieza	Equipo de Electroterapia con dos canales independientes y botón de paro de emergencia.	X		NO PROPONE			NO PROPONE			NO PROPONE	X
11	Pieza	Negatelefono de 1 pantalla LED, profesional, ultradelgado. Medidas alto 54.5cm, ancho 47cm, grosor 2.4cm mas menos. Sensor de encendido/apagado automático al levantar la palanca. Regulador de intensidad luminoso.	X		X			NO PROPONE	X		X	
12	Pieza	Ultrasonido para rehabilitación con transductor de 5 CM aproximadamente y con frecuencia de 1-3 MHz, con frecuencias continuas o pulsadas.	X		NO PROPONE			NO PROPONE			NO PROPONE	X
13	Pieza	Pistola Masajeadora de Percusión Profesional con Batería Recargable, 6 Cabezas y 20 Velocidades. Recargable	X		NO PROPONE			NO PROPONE			NO PROPONE	X
14	Pieza	Verina básica de metal con pinzas laterales, tamaño estándar, con ruedas y tres empujadores de metal y dos ejes de latón en la parte inferior con medidas de 83 cm largo X 40 cm ancho X 10 cm alto.	X		X		X				NO PROPONE	NO PROPONE
15	Pieza	Verina básica de metal con pinzas laterales, tamaño estándar, con ruedas y tres empujadores de metal y dos ejes de latón en la parte inferior con medidas de 83 cm largo X 40 cm ancho X 10 cm alto.	X		X		X				NO PROPONE	NO PROPONE
16	Pieza	Silla para médico de acero inoxidable con cubierta de piel o vinilpiel color blanco, con ruedas y porta brazos, medida ajustable de los 78 a los 90 cm, respaldo de 34 cm aproximadamente y ancho de 58 cm aproximadamente.		Se solicita medida ajustable de los 78 a los 90 cm y el proveedor no especifica el ancho de los 48 a los 63 cm y no especifica color.	NO PROPONE			NO PROPONE			NO PROPONE	NO PROPONE
17	Pieza	Mesa de exploración medica hidráulica de posiciones color blanco, de acero inoxidable.	X		NO PROPONE			NO PROPONE			NO PROPONE	NO PROPONE
18	Pieza	Concentrador de oxígeno portátil de 10L. Medidor de flujo variable 0.5 a 10 LPM, Purga de oxígeno 92% +/- 4% a 5 LPM, Indicadores de alarmas.	X		X		X		X		X	
19	Pieza	Equipo laser portátil de baja intensidad, indicado para el tratamiento del dolor, espasmos musculares, color articular, patologías músculo esqueléticas, lesiones de la piel. Características: - Diseño ligero y portátil - Equipo recargable		NO PRESENTA RCHA TÉCNICA	NO PROPONE			NO PROPONE			NO PROPONE	X
20	Pieza	Monitor de Signos Vitales Básico con pantalla de 8" como mínimo. Despliegue de ondas Fisiológicas al menos 3 ejes simultáneos, electrocardiograma, estimación de oxígeno, pleismografía y respiración.		NO PRESENTA RCHA TÉCNICA	X		X		X			NO PROPONE
21	Pieza	Carrero rojo. Material de plástico de alto impacto con manubrio para su conducción, ruedas antichoque, giratorias, sistema de frenado superior para desbloqueo de freno, mecanismo de seguridad, con tapa de RCP de material ligero y resistente de alto impacto instalable y lavable montado al carrero y con sujetadores, sujetador para tiraje de rescate, con polea para venoclisis ajustable e integrado, 5 sujetadores o divisores. Puerta suena, charola para desbloqueo. Seguro para sujetadores, base de baseura. Medidas 78 cm x 48 cm x 92 cm		Se solicita manubrio de plástico y el proveedor ofrece elementos adicionales y se solicita de 5 sujetadores o divisores giratorios y baseura	X		X		X		X	
22	Pieza	Desfibrilador automático externo. 1 desfibrilador externo semi automático, zoll aed plus en español, 1 juego de parches cpd-p para adulto, 1 juego de baterías desechables 123a, 1 estuche de traslado, 1 manual de operador y 1 caso de transporte de este equipo protegido.	X		NO PROPONE			NO PROPONE			NO PROPONE	X
23	Pieza	Cerrojo de seguridad de acero inoxidable articulo giratorio para porta -cubierta y porta-bandeja de Soleta de 1" x 1/8", de 30 cm de diametro, que se ajustan con pernos de seguridad color negro. Cubierta y bandeja tipo charola, con pesaria de 5 cm de altura. Estructura de tubo redondo de 1" de Diámetro, con rodillos giratorios planos de hule negro de 3" de diametro, sin freno. Medidas generales 68.5 cm de frente x 40.5 cm de fondo x 68 cm de altura	X		X		X				NO PROPONE	NO PROPONE
24	Pieza	Estuche de diagnostico (ultrasonido opcional) 3.5 V con batería recargable y estuche rígido.		Se solicita recargable y con estuche rígido, el proveedor no especifica si es recargable y si incluye estuche.	X						NO PROPONE	X

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO

FALLO Y RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DE COMITÉ

LPLCC28/2022


“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS”

(Sistema de Evaluación Binario)

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES									
		JOSE MARIA DE ALBA CERNA		IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV		INFARIND SA DE CV		MEDCO MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES SA DE CV		SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SA DE CV	
NÚMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	PRESENTA	NO PRESENTA
1	ANEXO 2 (PROPUESTA TÉCNICA)	X		X		X		X		X	
2	ANEXO 3 (PROPUESTA ECONÓMICA)	X						X			NO CUMPLE CON EL TIEMPO DE ENTREGA ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2 DE LAS BASES
3	ANEXO 4 (CARTA DE PROPOSICIÓN)	X		X		X		X		X	
4	ANEXO 5 (ACREDITACIÓN O DOCUMENTOS QUE LO ACREDITE)	X		X		X		X		X	
5	ANEXO 6 (DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y NO OCLUSIÓN DE PROVEEDORES)	X		X		X		X		X	
6	ANEXO 7 (DECLARACIÓN DE APORTACIÓN CINCO AL MILLAR)	X NO APORTA		X NO APORTA		X NO APORTA		X NO APORTA		X NO APORTA	
7	ANEXO 8 (ESTRATIFICACIÓN) OBLIGATORIO PARA "PARTICIPANTES" MYPMES	X MICRO		X MEDIANA		X MICRO		X MICRO		X PEQUEÑA	
8	ANEXO 9 (COPIA LEGIBLE DEL DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES CON LA FISCALÍA NO MAYOR DE 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA PROPUESTA, EN EL QUE SE OFERTA EL DENTRO POSITIVO AUTORIZADO EN LA SAT, CONFORME AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS REGLAS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL 2019)	X		X		X		X			NO PRESENTA EL DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES
9	ANEXO 10 MANIFIESTO Y CONSTANCIA IMPRESA DE OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR EL IMSS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN MAYOR A 30 DÍAS ANTERIORES A LA ENTREGA DE LA PROPUESTA	X		X		X		X			NO PRESENTA LA CONSTANCIA IMPRESA DE OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL
10	ANEXO 11 (IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE)	X		X		X		X		X	
11	FICHA TÉCNICA	X		X		X		X		X	
14	RELACIÓN DE ANEXOS (NO OBLIGATORIO)	X		X		X		X		X	
15	CÓPIA VIGENTE DEL RUPC (NO OBLIGATORIO)	X		X		X		X		X	

ASPECTOS ECONÓMICOS			LICITANTES									
			JOSE MARIA DE ALBA CERNA		IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV		INFARIND SA DE CV		MEDCO MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES SA DE CV			
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	PRECIO UNITARIO		PRECIO UNITARIO		PRECIO UNITARIO		PRECIO UNITARIO		PRECIO UNITARIO	
			IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
1	1	Autoclave. Equipo de esterilización a vapor con control de ciclos de esterilización por microcontrolador, cámara y charolas en acero inoxidable. Capacidad 12 LTS con tres programas de esterilización y programa de secado. Con medidas de 33 CM de ancho, 35,5 CM de alto y 63 CM de largo más o menos	49,100.00	\$	49,100.00		49,172.00		20,511.43		20,511.43	
2	1	Báscula con estadiómetro, para medir estatura y peso, de gran exactitud. Lectura directa en dos varas una de 220 kg y otra de 20 kg. Escala legible en ambas barras, la principal de 20 en 20 kg. División mínima de 100 gr. Barra de Zamac con cromado mate. Pilones curvados de Zamac esmaltados colores beige o blanco. Estadiómetro: Diseño, telescópico, 2 puntos de fijación a la báscula para mejor ensamble. Escala para medir estatura hasta de 1.95mts. Mide altura desde 75cm a 193 cm, fabricado en lámina de acero, pintura epóxica hornada de alta resistencia, Tapete antideslizante.	8,200.00	\$	8,200.00		9,095.00		6,896.54		6,896.54	
3	2	Centilla hidráulica para fisioterapia, 4 secciones. Dimensiones 70 x 190 cm más o menos. La estructura está fabricada en tubo de acero y recubierta de pintura epóxica en horno. Sistema de ruedas escomotables, mediante pedal único. Regulación de altura mediante mando de pie. Patas redondeadas de alta resistencia. Relleno de espuma de 4 cm de grosor más o menos y cubierta en tela tipo vinil que no absorbe líquidos y es fácil de limpiar. Con soporte de hasta 180 kg aproximadamente.	28,000.00	\$	56,000.00		-		3,092.31		6,184.62	
4	1	Electrocardiograma portátil con 3 canales, pantalla LCD de 2.83" con batería recargable	15,800.00	\$	15,800.00		25,800.00		40,767.23		40,767.23	
5	2	Estimulador muscular y de sistema nervioso ultra TENS Digital Recargable con cargador incluido.	4,780.00	\$	9,560.00		-		1,789.23		3,538.46	
6	2	Estimulador muscular y de sistema nervioso ultra EMS Digital Recargable con cargador incluido.	4,800.00	\$	9,600.00		-		-		-	
7	2	Lámpara con haz direccional, infrarrojo para terapia física con interruptor de intensidad y apagado. Altura ajustable	5,590.00	\$	11,180.00		-		3,184.20		6,368.40	
8	1	Compresor de termoterapia de acero inoxidable, grado médico. Capacidad para 4 compresores de termoterapia estándar incluidos con la compresora de aproximadamente 34 cm largo x 25 cm ancho x 41 cm alto. Con regulador termostático de temperatura	14,567.00	\$	14,567.00		-		-		-	
9	2	Mesa púente con bandeja inclinable, altura ajustable. Base en forma de H de acero con terminado esmaltado con cuatro ruedas giratorias. Con altura de entre 75 cm y 108 cm más o menos, con bandeja de 36.5 x 76.5 CM más o menos.	4,780.00	\$	9,560.00		-		7,461.54		14,923.08	
10	1	Equipo de Electroterapia con dos canales independientes y botón de paro de emergencia	45,500.00	\$	45,500.00		-		-		-	

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLCC-28/2022 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS”

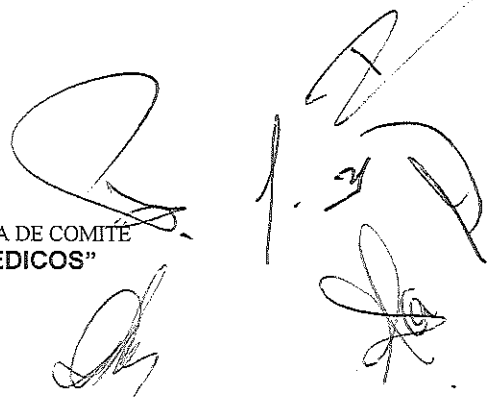

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO
FALLO Y RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLCC28/2022
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS”
(Sistema de Evaluación Binario)

11	1	Hegistoscopio de 1 pantalla LED, profesional, ultradelgado. Medidas alto 54.5cm, ancho 47cm, grosor 2.4cm más o menos. Sensor encendido/apagado automático al levantar la pantalla. Regulador de intensidad luminosa.	5,530.00	\$ 5,530.00	7,702.00	7,702.00	-	-	8,900.00	8,900.00	-	-
12	1	Ultrasonido para rehabilitación con transductor de 5 CM aproximadamente y con frecuencia de 1-3MHz, con frecuencias continuas o pulsadas.	32,600.00	\$ 32,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
13	1	Padillo Masajeador de Punción Profesional con Batería Recargable, 6 Cabezales y 20 Vendajes. Recargable.	10,570.00	\$ 10,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-
14	4	Monitor de flujo con pantalla color sensor ultrasónico, con que o tres unipolares de ental y dos cajones de lámina en la parte inferior con medidas de 63 cm largo X 30 cm ancho X 24.5 cm altura aproximadamente.	5,020.00	\$ 20,080.00	7,900.00	31,600.00	10,000.00	40,000.00	-	-	-	-
15	2	Viruta sencilla de metal con pintura color blanco esmaltada con puertas e abalorios con chapa y puente abalorio con chapa con medidas aproximadas de 160 x 40 x 80 cm más o menos.	5,400.00	\$ 10,800.00	5,520.00	11,040.00	4,923.08	9,846.16	-	-	-	-
16	3	Silla para médico de acero inoxidable con cubierta de piel o vinil. color blanco, con ruedas y porta brazos, medidas ajustable de los 79 a los 90 cm, respaldo de 34 cm aproximadamente y ancho de 56 cm aproximadamente.	4,800.00	\$ 14,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
17	1	Mesa de exploración médica hidráulica de posiciones color blanco, de acero inoxidable.	8,950.00	\$ 8,950.00	51,700.00	51,700.00	-	-	-	-	-	-
18	3	Concentrador de oxígeno portátil de 10L. Medidor de flujo variable 0.5 a 10 LPM. Puntos de oxígeno 82% +/- 4% a 5 LPM. Indicadores de alarmas.	33,600.00	\$ 101,400.00	54,100.00	162,300.00	37,692.31	113,076.93	159,000.00	477,000.00	-	-
19	1	Equipo laser portátil de baja intensidad, indicado para el tratamiento del dolor, espasmos musculares, dolor articular, patologías musculares esqueléticas, tendinosis y de la piel. Características: - Diseño ligero y portátil- Equipo recargable	6,280.00	\$ 6,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-
20	5	Monitor de Signos Vitales Básico con pantalla de 8" como mínimo. Despliegue de curvas fisiológicas al menos 3 curvas simultáneas: electrocardiograma, saturación de oxígeno, pleiomografía y respiración.	18,000.00	\$ 90,000.00	26,500.00	142,500.00	33,846.15	169,230.75	26,800.00	144,000.00	-	-
21	1	Carril tipo. Material de plástico de alto impacto con manubrio para su conducción, ruedas orientables giratorias, sistema de frenado superior para deslizarlo y frenarlo, mecanismo de seguridad, con tabla de RCP de material ligero y resistente de alto impacto instalable y lavable montada al carril y con sujetadores, sujeción para la parte de oxígeno, con pesta para ventilación ajustable e integrada, 5 cajones o divisiones. Porta suero, charola para deslizador. Seguro para cajones, base de base. Medidas 78 cm x 48 cm x 82 cm	26,050.00	\$ 26,050.00	47,488.00	47,488.00	40,769.23	40,769.23	43,300.00	43,300.00	-	-
22	1	Desfibrilador automático externo. 1 desfibrilador. Externo semi automático, 200 and plus en español. 1 juego de parches esp-i para adulto, 1 juego de baterías desechables 135a. 1 estuche de traslado, 1 manual de operador y 1 calcomanía de uso cardio protegido	44,200.00	\$ 44,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-
23	2	Carril de curaciones de acero inoxidable arillos giratorios para porta - cubeta y porta bandeja de 50cm de 1" x 1/8", de 30 cm de diámetro, que se ajustan con perillas de polipropileno color negro. Cubierta y entrapado tipo charola, con perillas de 5 cm de altura. Estructura de tubo reducida de 1" de Diámetro, con rodajas giratorias planas de hule negro de 3" de diámetro, sin freno. Medidas generales 89.5 cm de frente x 40.5 cm de fondo x 69 cm de altura.	6,980.00	\$ 13,960.00	9,352.00	18,704.00	9,153.05	18,307.70	-	-	-	-
24	2	Estuche de diagnóstico (ultrasonido opcional) 2.5 V con batería recargable y estuche rígido.	10,430.00	\$ 20,860.00	10,430.00	20,860.00	74,523.08	149,046.16	-	-	-	-
SUBTOTAL			634,807.00		577,961.00		638,466.89		785,400.00		0.00	
SUBTOTAL			101,569.12		92,473.76		102,314.67		125,678.40		0.00	
SUBTOTAL			736,376.12		670,434.76		741,781.56		911,158.40		0.00	
TOTAL ADJUDICADO			322,737.00		163,360.00		40,769.23		0.00		0.00	
IVA			51,837.92		26,137.60		6,823.08		0.00		0.00	
TOTAL			374,574.92		189,497.60		47,592.31		0.00		0.00	

RESULTANDO

PRIMERO.- Con base en el dictamen y una vez considerados todos los documentos que integran el expediente del proceso de adquisición identificado Licitación LPLCC-28/2022 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS” se resuelve adjudicar las partidas 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, al licitante JOSE MARIA DE ALBA CERNA por un monto con IVA incluido de \$374,374.92 (TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.), las partidas 20, 24, al licitante IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV, por un monto con IVA incluido de \$189,497.60 (CIENTO OHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N.), la partida 21 al licitante INFARIND SA DE CV, por un monto con IVA incluido de \$47,292.31 (CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 31/100 M.N.), toda vez que sus propuestas resultan solventes, ya que cumplen con los requisitos legales, técnicos y administrativos solicitados en bases, y cumplen con las condiciones en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Sistema DIF Jalisco, lo anterior con fundamento en el Artículo 67 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y Artículo 69 del reglamento de la ley, en virtud de que resultan favorables y convenientes toda vez que no es superior al 10% o inferior en un 40% respecto de la media de precios que arroja la investigación de mercado, de conformidad al artículo 71 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Se declaran desiertas las partidas 1, 2, 3, 5, 15, 16, por precio inconveniente, toda vez que los precios no se encuentran dentro de los porcentajes establecidos en el artículo 71 numeral 1 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Así mismo se declaran desiertas las partidas 6, 16, 19, por incumplimientos en los aspectos administrativos.

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLCC-28/2022 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS”

SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO
FALLO Y RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLCC28/2022
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS”
(Sistema de Evaluación Binario)

Se desecha la propuesta del licitante **SERGO EQUIPOS Y HERRAMIENTA SA DE CV**, toda vez que incumple con los aspectos administrativos solicitados en el numeral 10.1 anexo 9 y 10 de las bases que rigen la presente licitación.

SEGUNDO. En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes y servicios, por parte del proveedor adjudicado, se hará acreedor a cubrir como pena convencional lo señalado en el punto 23 de la Convocatoria que rige el presente proceso.


TERCERO.- Las condiciones de pago por parte del organismo serán como se indica en el punto 3 de la convocatoria.


CUARTO.- La fecha, lugar y hora para la firma del Contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de anticipos; será como se indica en el punto 17, 18, 19 y 20 de las Bases que rigen la presente licitación.

QUINTO.- Para efectos de notificación a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, una copia del acta y del dictamen a través del medio electrónico que se tenga para hacerles de su conocimiento, así también se fija un ejemplar en: Av. Alcalde 1220, col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco, primer piso, en la Unidad Centralizada de Compras. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

SEXTO.- Se levanta la presente acta de conformidad con los artículo 23, 24 y 31 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, las consultas, asesorías, análisis, opinión, orientación y resoluciones que son emitidas por este Comité de Adquisiciones, son tomadas considerando única y exclusivamente la información, documentación y dictámenes que los sustentan y fundamentan y que son presentados por parte de los licitantes y servidores públicos a quienes corresponda, siendo de quien los presenta la responsabilidad de su revisión, acciones, veracidad, faltas u omisiones en su contenido.


SÉPTIMO- Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firman el presente documento las personas que intervinieron en este acto de adjudicación, siendo las 10:20 hrs., firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

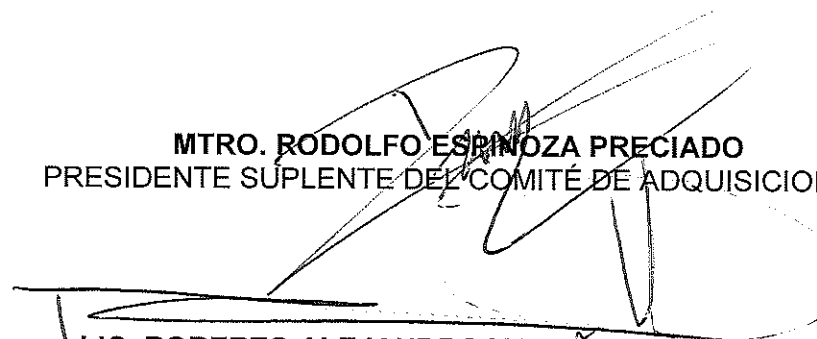
MTRO. RODOLFO ESPINOZA PRECIADO
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

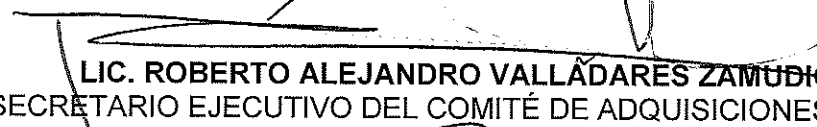
LIC. ROBERTO ALEJANDRO VALLADARES ZAMUDIO
SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES


LIC. JOSE GUADALUPE PEREZ MEJIA
VOCAL EN REPRESENTACION DE CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO SP

FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLCC-28/2022 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS”

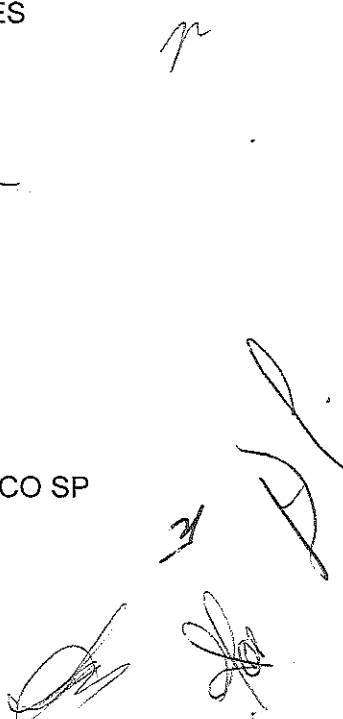

**SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO
FALLO Y RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA CON CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLCC28/2022
“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS”
(Sistema de Evaluación Binario)**




LIC. VERONICA VENEGAS CASTRO
VOCAL EN REPRESENTACION DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL



SRA. ROSA MARIA NAVA CAZARES
VOCAL EN REPRESENTACIÓN DEL COMCE DE OCCIDENTE AC



LCP. ALMA PATRICIA CALLEROS NUÑO
REPRESENTANTE DE LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DEL SISTEMA DIF JALISCO.



MTRO. FRANCISCO ALONSO MORENO MUÑOZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ACUERDOS Y ASUNTOS JURIDICOS



LIC. ANA ELENA GONZALEZ JAIME
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DIF JALISCO



LIC. DIEGO ARMANDO SEGURA DELGADILLO
INVITADO EN REPRESENTACION DE SECRETARIA DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL